

## ● 受託中止項目一覧

### 中止項目一覧(代替項目あり)

コード (統一コード)	検査項目名	代替項目	注
25701 (5A100)	イヌ(上皮)	[25711]イヌ(フケ)(皮膚)	注4
19900 (5F431)	麻疹(CF)髄液	[ - ]麻疹 IgG(EIA)	注4
10200 (5F431)	麻疹(CF)	[10210]麻疹 IgG(EIA)	注5

### 中止項目一覧(代替項目なし)

コード (統一コード)	検査項目名	中止理由	注
33420 (4F091)	尿中HCG -コアフラグメント	検査試薬製造中止のため	注6

## アレルギー イヌ皮膚とイヌ上皮の比較

### クラス相関

(n=634)

代替品 e5 犬皮膚	6				1	5	4	2
	5			2	5	19	8	2
	4		1	18	47	19	4	1
	3	26	20	77	53	3		
	2	113	28	34	2			
	1	37	5	1				
	0	95		2				
		0	1	2	3	4	5	6

現行品 特異IgE e2 犬上皮

### 判定一致率

(n=634)

		現行品 特異IgE e2 犬上皮		
		陰性	疑陽性	陽性
代替品 e5 犬皮膚	陰性	95	0	2
	疑陽性	37	5	1
	陽性	139	49	306

陽性一致率:99.4%  
(疑陽性例を含む)


陰性一致率:35.0%

判定一致率:64.0%

## 神経特異エノラーゼ(NSE)

現行試薬の販売中止に伴い同一メーカーが販売するIRMA法に基づく試薬に変更致します。  
なお、新旧二法の相関は良好で基準値等の変更はありません。

### 新旧二法の相関図

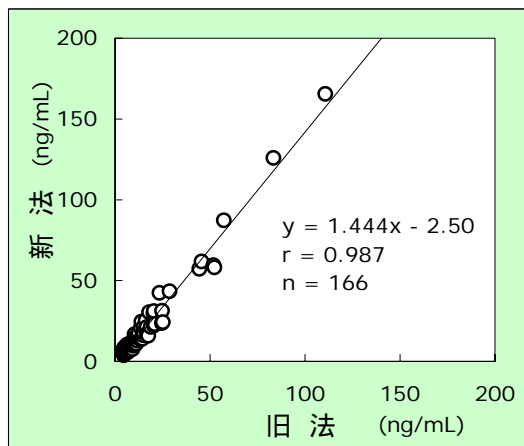

新検査法の参考文献

神経特異エノラーゼ 医学と薬学 39(2):351-356, 1998