

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
 この度、下記検査項目の現行試薬の販売中止に伴い、測定試薬の変更を
 させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内致します。
 誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜ります
 ようお願い申し上げます。 敬白


* * * * * 記 * * * * *

■内容変更項目


検査項目名 (項目コード No)	変更箇所	新	旧
シクロスポリン (34520)	検査方法	CLIA法	FPIA法
	最小報告値	30以下 ng/mL	25以下 ng/mL
タクロリムス (34525)	検査方法	CLIA法	EIA法
	最小報告値	2.0未満 ng/mL	1.5未満 ng/mL

■新旧相関図

《シクロスポリン相関》

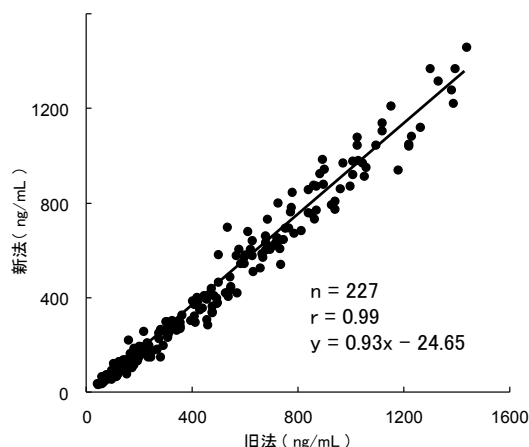

《タクロリムス相関》

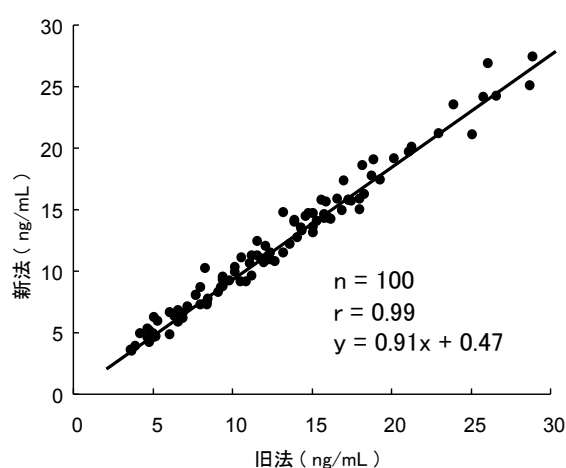

■変更実施日

平成 21 年 10 月 1 日 (木) 受付分より